


Bestellformular - Flex BK - Transtibial

Name des Patienten (optional):

Umfang des Prothesenschafts am oberen Ende des Covers [mm]



Um das Umfangsmaß genau zu ermitteln, markieren Sie bitte genau das obere Ende des Covers. Bitte messen Sie sehr sorgfältig an der Markierung (siehe Bild). Ein abrutschen beim messen nach oben oder unten kann zu einer Änderung des Umfangs um mehrere Zentimeter zur Folge haben. Wenn wir eine Kniekappe haben, muss das Covers immer unter der Hülle sein.


Des Covers darf nie auf der Kniekappe sein!!!

3



Sollten wir ein Loch für die PIN machen, falls vorhanden?


☐ No




Höhe des Cover in [mm]

4

Wir messen vom niedrigstem Punkt des Fußes. Fall als Bild, der untere Teil kann bis zur Form der Fußkosmetik beschliffen werden



1



A [mm]

B [mm]

Fuß-Hersteller, Typ, Größe und Seite

Zum Beispiel: OB Taleo IC50 L29

Adapter

- ☐ 30
☐ 34

Matte und halbmatte Farben - Tattoos nicht verfügbar

- ☐ 25 ☐ 45 ☐ 65 ☐ 85

Glänzende Farben & matter Lack

- ☐ Skin1 ☐ Skin2 ☐ Skin3
☐ Skin4 ☐ Graphit ☐ Schwarz
☐ Matter Lack (Extra Kosten)

Tattoo (Extra Kosten)

Nur verfügbar für Skin 1, Skin 2, Skin 3, Skin4 Hautfarbe

Nummer aus dem Katalog der Webiste

Zum Beispiel: 07-1001; eigen

z.B.:
4WR95=3

Check Liste:

☐

Foto der Fußkosmetik


Foto des Fußes aus einer Höhe von ca. 1 Meter. Der Fokus der Kamera ist hierbei auf den Pyramidenanschluss zu richten. Dies ist sehr wichtig!


☐

4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein

Patienten müssen die Socken am gesunden Bein nicht ausziehen.

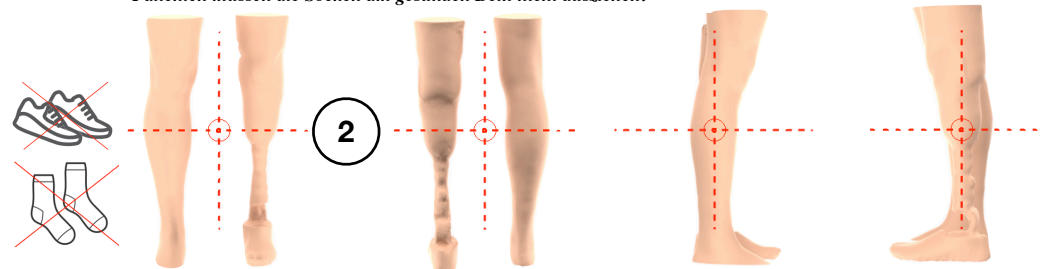
☐

Scan der Wade des Patienten, ggf. mit Prothese.

☐

Scannen Sie Prothesen ohne den Patienten.




Die Scandateien müssen .stl / .obj sein.




- Im Auslieferungszustand ist das distale Ende des Covers flach.
- Bei einer geschwungenen Fußkosmetik kann der untere Teil des Covers an die Form des Fußes angepasst werden.

Sehr wichtige Informationen – nicht senden.

1

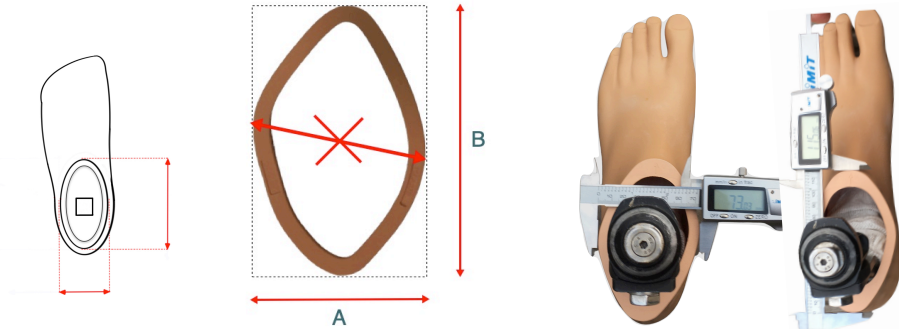


2

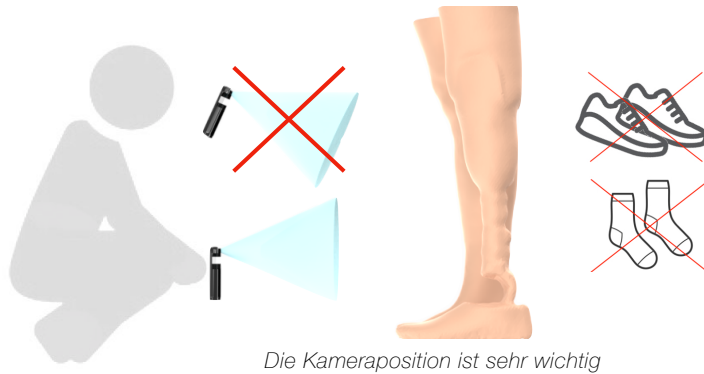

Die Kameraposition ist sehr wichtig


3

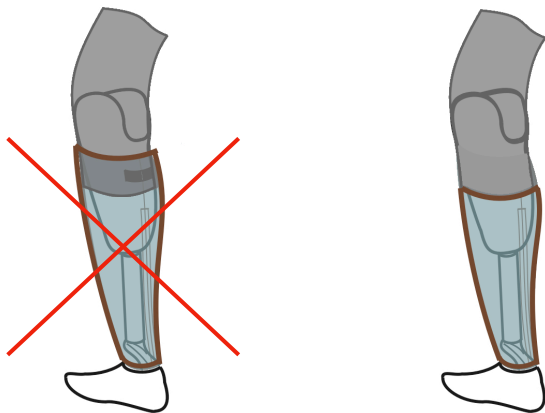

Des Covers darf nie auf der Kniekappe sein!!!

Bei einer Kniekappe muss sich die Cover immer unterhalb der Hülle befinden!

4

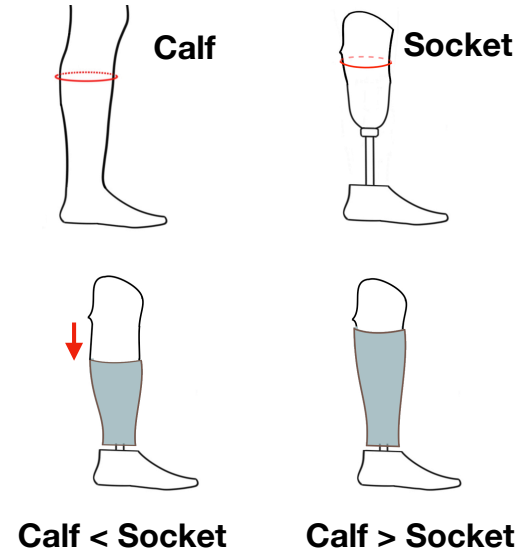

Wenn der Umfang des Prothesenschaftes an seiner breitesten Stelle dem Wadenumfang entspricht (oder größer ist), sollte die Höhe des Covers so gering wie möglich gewählt werden. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Aufsetzen des Covers den Schaftumfang vergrößert und im Zusammenspiel mit dem gesunden Bein möglicherweise nicht gut aussieht.

FARBEN - NICHT SENDEN.

Matte und halbmatte Farben - Tattoos nicht verfügbar



Glänzende Farben - Tattoos erhältlich

